

Warszawa: Dostawa zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Numer ogłoszenia: 305832 - 2010; data zamieszczenia: 24.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6323221 w. 2328, faks 022 6326681 , strona internetowa www.icho.edu.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa placówka naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii a także przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi urządzenia. W skład zestawu powinny wchodzić: - komora wysokociśnieniowa; - prasa hydrauliczna; - zasilacz hydrauliczny; - komplet węży hydraulicznych, zaślepek, korków, uszczelek itp. Kompletny zestaw musi być gotowy do pracy w momencie przekazania Zamawiającemu. Dostarczony zestaw musi spełniać wymagania nie gorsze niż: Komora wysokociśnieniowa - komora dwupłaszczowa typu tłok-cylinder, wykonana ze stali odpornej chemicznie np. 45HNMF; - ciśnienie pracy 1300 MPa; - temperatura pracy: 20°C - 100°C; - objętość komory: 25-35 ml; - płaszcz grzejny umożliwiający podłączenie termostatu; - zestaw uszczelek do 50 cykli ciśnieniowych; - pięć ampulek teflonowych o objętości 5-10 ml. Prasa hydrauliczna - prasa trójkolumnowa; - siła maks. 350 kN; - ciśnienie hydrauliczne 40 MPa. Zasilacz hydrauliczny - ciśnienie 40 MPa - wydajność 0,06 - 0,4 litr/min, regulacja elektroniczna; - przetwornik ciśnienia 60 MPa, 0.5% + kontroler mikroprocesorowy z funkcją wyboru ciśnienia maksymalnego - hydrauliczny zawór bezpieczeństwa - zasilanie 230 - 240 V Zasilacz powinien umożliwiać regulację szybkości wzrostu ciśnienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.50.00-4, 42.63.61.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

• **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


- **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

W dwóch kolejno przeprowadzonych postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta. Warunki zamówienia nie zostały w znaczący sposób zmienione.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

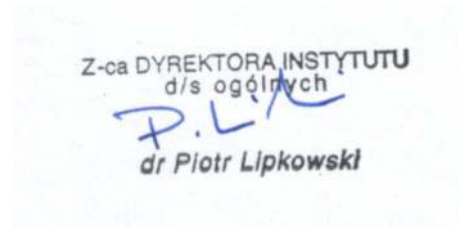

Z-ca DYREKTORA INSTYTUTU
d/s ogólnych
P. Lipkowski
dr Piotr Lipkowski